



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 9/2018**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Lecznicygo w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia.

Treść pytania:

Pytanie 1 (Dotyczy poz. 1, część nr 17 – Sprzęt transportowy: śliskie deski do przemieszczania pacjenta oraz rolki do transportu).

„Informujemy, iż wskazany w SIWZ rozmiar deski 170-180x50 cm będzie adekwatny do przekładania pacjenta w pozycji leżącej tj. z łóżka na wózek transportowy, ale będzie za duży do przełożenia pacjenta z łóżka na fotel – do tego celu optymalny byłby rozmiar 75x33 cm, który umożliwia przesuwanie pacjenta w pozycji siedzącej.

W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie potrzeb i dopuszczenie jednego z poniższych rozwiązań:

a) Składany przenośnik z łatwo przesuwaną taśmą do transferów pomiędzy dwiema powierzchniami bocznymi, takimi jak łóżka czy nosze, o następujących parametrach:

Przenośnik do przekładania pacjenta w pozycji poziomej, taśmowy, składany
Wymiary: 180x49 cm
Waga max. 1,5 kg
Płyta bazowa wykonana lekkiej pianki polietylenowej, przeznaczona do dezynfekcji powierzchniowej,
Taśma wykonana w 100% z nylonu pokrytego silikonem, przeznaczona do dezynfekcji powierzchniowej i prania w temp. 60st.C,
Obciążenie maksymalne: 200 kg przy 20 cm różnicy wysokości lub odstępnie pomiędzy powierzchniami
Możliwość złożenia na pół w celu ułatwienia przechowywania
Przezierny dla promieni RTG
Wolny od lateksu
Dostępność taśm wymiennych oraz taśm polietylenowych jednorazowych

Jak na rysunku poniżej:





Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



b) Składany przenośnik z łatwo przesuwaną taśmą do transferów pomiędzy dwiema powierzchniami bocznymi, takimi jak łóżka czy nosze, o następujących parametrach:

<i>Przenośnik do przekładania pacjenta w pozycji poziomej, taśmowy,</i>
<i>Wymiary: 180x50 cm</i>
<i>Waga max. 3,5 kg,</i>
<i>Płyta bazowa wykonana z poliwęglanu wzmocnionego kompozytem żywicy, pokryta laminatem poliester/PVC, przeznaczona do dezynfekcji powierzchniowej,</i>
<i>Taśma wykonana ze 100% poliamidu, ze zgrzewanymi szwami, przeznaczona do dezynfekcji powierzchniowej i prania w temp. 60st.C,</i>
<i>Obciążenie maksymalne: 120 kg przy 20 cm różnicy wysokości lub odstępnie pomiędzy powierzchniami</i>
<i>Możliwość złożenia na pół w celu ułatwienia przechowywania</i>
<i>Dostępność taśm wymiennych poliamidowych oraz taśm polietylenowych jednorazowych</i>

Jak na rysunku poniżej:






Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

c) Deska ślizgowa wykonana z polietylenu, o wymiarach 170x50cm, przeznaczona do transportowania pacjentów między łózkami, a noszami, przeznaczona dla pacjentów o maksymalnej wadze do 135 kg, odporna na wysokie temperatury i promieniowanie UV, z uchwytami, jak na rysunku poniżej



W komplecie z łatwoślizgiem, o udźwigu do 150 kg, do przekładania pacjenta w pozycji poziomej, z 8 uchwytami, o wymiarach: 200 x 90 cm, wykonany w 100% z poliamidu, z możliwością prania w temperaturze do 60°C, jak na rysunku poniżej:

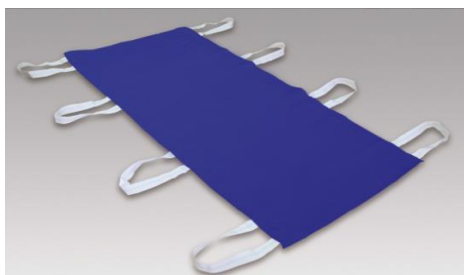

d) Deska ślizgowa, o wymiarach 75 x 33 cm, o udźwigu do 135 kg, przeznaczona do transferu pacjentów siedzących pomiędzy dwoma powierzchniami łóżka, krzesła, wózka, siedzenia samochodowego, toalety itp. , odpornej na wysokie temperatury i promienie UV. Po jednej stronie, dla lepszej przyczepności antypoślizgowa taśma, 2 linie gięcia dla lepszego dopasowania do każdej powierzchni, jak na rysunku poniżej:



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



W komplecie z łatwoślizgiem, przeznaczonym dla pacjentów o wadze do 150 kg, wykonanym z tkaniny technicznej o niskim współczynniku tarcia, ultra-wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i przesuwanie, z możliwością prania w 60°C, jak na rysunku poniżej:



Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie z wariantu a).

Dopuszczalne obciążenie należy rozumieć jako 120 kg minimalne i 200 kg maksymalne.

Treść pytania:

Pytanie 2 (Dotyczy poz. 2, część nr 17 – Sprzęt transportowy: śliskie deski do przemieszczania pacjenta oraz rolki do transportu).

„Prosimy o dopuszczenie przenośnika taśmowo-rolkowego w rozmiarze 76 x 36 x 3 cm”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści przenośnik taśmowo-rolkowy o proponowanym rozmiarze.

Treść pytania:

Pytanie 3 (Dotyczy poz. 1, część nr 19 – Podnośniki).

„Prosimy o dopuszczenie podnośnika z niezalegalizowaną wagą do 300 kg”.



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści podnośnika z niezalegalizowaną wagą.

Treść pytania:

Pytanie 4 (Dotyczy poz. 1, 2, część nr 19 – Podnośniki).

„Prosimy o dopuszczenie podnośnika o udźwigu do 180 kg, z mechanicznie otwieraną podstawą nóg, szerokość podstawy: 650 (szerokość F) - 1070 mm (szerokość G), minimalna wysokość podnoszenia: 620 mm (wysokość B na rysunku), co pozwala podnieść pacjenta leżącego z poziomu podłogi, maksymalna wysokość podnoszenia, maksymalna wysokość podnoszenia, maksymalna wysokość podnoszenia (wysokość C na rysunku): 1800 mm, wysokość podwozia: 113 mm”.

Odpowiedź:

Dopuszcza podnośnik o proponowanych parametrach.

Treść pytania:

Pytanie 5 (Dotyczy poz. 1, 2, część nr 19 – Podnośniki).

„Prosimy o dopuszczenie podnośnika o udźwigu do 180 kg, z elektrycznie otwieraną podstawą nóg, szerokość podstawy: 650 (szerokość F) - 1070 mm (szerokość G), minimalna wysokość podnoszenia: 620 mm (wysokość B na rysunku), co pozwala podnieść pacjenta leżącego z poziomu podłogi, maksymalna wysokość podnoszenia, maksymalna wysokość podnoszenia, maksymalna wysokość podnoszenia (wysokość C na rysunku): 1800 mm, wysokość podwozia: 113 mm”.

Odpowiedź:

Dopuszcza podnośnik o proponowanych parametrach.

Treść pytania:

Pytanie 6 (Dotyczy poz. 1, 2, część nr 19 – Podnośniki).


„Prosimy o dopuszczenie podnośnika o udźwigu do 300 kg, z elektrycznie otwieraną podstawą nóg, szerokość podstawy: 700 (szerokość F) - 1050 mm (szerokość G), minimalna wysokość podnoszenia: 660 mm (wysokość B na rysunku), co pozwala podnieść pacjenta leżącego z poziomu podłogi, maksymalna wysokość podnoszenia, maksymalna wysokość podnoszenia (wysokość C na rysunku): 1820 mm, wysokość podwozia: 113 mm”.

Odpowiedź:

Dopuszcza podnośnik o proponowanych parametrach.



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

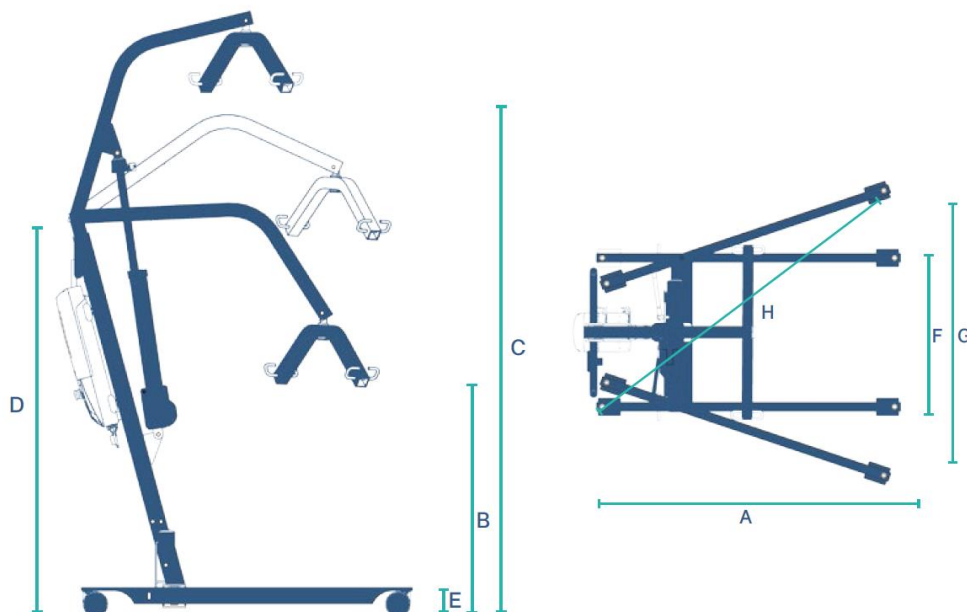

Treść pytania:

Pytanie 7 (Dotyczy poz. 1, 2, część nr 19 – Podnośniki).

„Prosimy o dopuszczenie nosidełek wykonanych z jersey’u, z możliwością prania w 70°C”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści nosidełek wykonanych z jersey’u.

Treść pytania:

Pytanie 8 (Dotyczy poz. 1, 2, część nr 19 – Podnośniki).

„Prosimy o podanie, czy Zamawiający wymaga nosidełek z podparciem głowy?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści nosidełka z podparciem głowy.

Treść pytania:

Pytanie 9 (Dotyczy poz. 1, 2, część nr 23 – Materace przeciwoleżynowe wersja I).

„Prosimy o określenie oczekiwanej skuteczności terapeutycznej tj. stopnia odleżyn i wagi pacjenta, do której materaca ma realizować funkcję terapeutyczną?”



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga w pozycji nr 1 materacy przeciwodleżynowych do wszystkich stopni odleżyn z maksymalnym obciążeniem nie mniejszym niż 200 kg. W pozycji nr 2 Zamawiający wymaga materace przeciwodleżynowe do II stopnia odleżyn włącznie z dopuszczonym maksymalnym obciążeniem do 200 kg.

Treść pytania:

Pytanie 10 (Dotyczy poz. 1, 2, część nr 23 – Materace przeciwodleżynowe wersja I).

„Czy zamawiający dopuści produkty o parametrach lepszych niż wyspecyfikowane?”

Odpowiedź:

Zamawiający określił minimalne parametry materacy jakich oczekuje, jednocześnie dopuszczając lub nie pewne możliwości materacy, które wynikały z pytań ze strony Wykonawców. Dopuszczenie parametrów lepszych niż wyspecyfikowane jest pojęciem zbyt ogólnym. Zamawiający wymaga zaoferowania materacy spełniających wymagania określone w opisie oraz w późniejszych odpowiedziach na pytania.

Treść pytania:

Pytanie 11 (Dotyczy poz. 1, część nr 23 – Materace przeciwodleżynowe wersja I).

„Prosimy o dopuszczenie materaca wymiennego o wysokości 19-21 cm i 10 stopniowej regulacji ciśnienia w pompie w zakresie 15-40 mmHg.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści materaca o proponowanej wysokości, natomiast dopuści z 10 stopniową regulacją ciśnienia w pompie w proponowanym zakresie.

Treść pytania:

Pytanie 12 (Dotyczy poz. 2, część nr 23 – Materace przeciwodleżynowe wersja I).

„Czy materac do opieki długoterminowej ma posiadać komory wykonane z poliuretanu?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści materac z komorami wykonanymi z proponowanego materiału.

Treść pytania:

Pytanie 13 (Dotyczy poz. 2, część nr 23 – Materace przeciwodleżynowe wersja I).

„Prosimy o dopuszczenie pompy o wydajności min. 6 l/min z zakresem regulacji ciśnienia 30-80



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

mmHg.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści pompy o proponowanej wydajności i proponowanym zakresie regulacji ciśnienia.

Treść pytania:

Pytanie 14 (Dotyczy część nr 33 – Materace przeciwoleżynowe wersja II).

„Prosimy o dopuszczenie 10 stopniowej regulacji ciśnienia w pompie w zakresie 15-40 mmHg czasu cyklu 10 min, wydajności pompy 9l/min i pomoru mocy 7W.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści materac o proponowanych parametrach.

Treść pytania:

Pytanie 15 (Dotyczy część nr 33 – Materace przeciwoleżynowe wersja II).

„Prosimy o dopuszczenie pokrowca paroprzepuszczalnego wykonanego z PU na podłożu poliestrowym.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści pokrowiec paro przepuszczalny wykonany z PU na podłożu poliestrowym.

Treść pytania:

Pytanie 16 (Dotyczy część nr 33 – Materace przeciwoleżynowe wersja II).

„Prosimy o określenie oczekiwanej skuteczności terapeutycznej tj. stopnia odleżyn i wagi pacjenta, do której materaca ma realizować funkcję terapeutyczną.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga materacy do III stopnia odleżyn włącznie z dopuszczalnym maksymalnym obciążeniem do 140 kg.